


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
NIKO TUBE-FIX		Katalogové číslo
Fixace - F	Počet stran:1/2	Viz níže.


### Popis výrobku:

K fixaci vzduchovodu a endotracheální rourky.

Katalogové číslo	Typ	Barva
49-650-M	K fixaci vzduchovodu i endotracheální rourky	Polyamid v barvě kůže
49-655-M	K fixaci endotracheální rourky	Polyamid v barvě kůže
49-650-F	K fixaci vzduchovodu i endotracheální rourky	Modrý pěnovitý
49-655-F	K fixaci endotracheální rourky	Modrý pěnovitý

### Návod k použití:

Aplikujte dle přiloženého nákresu.

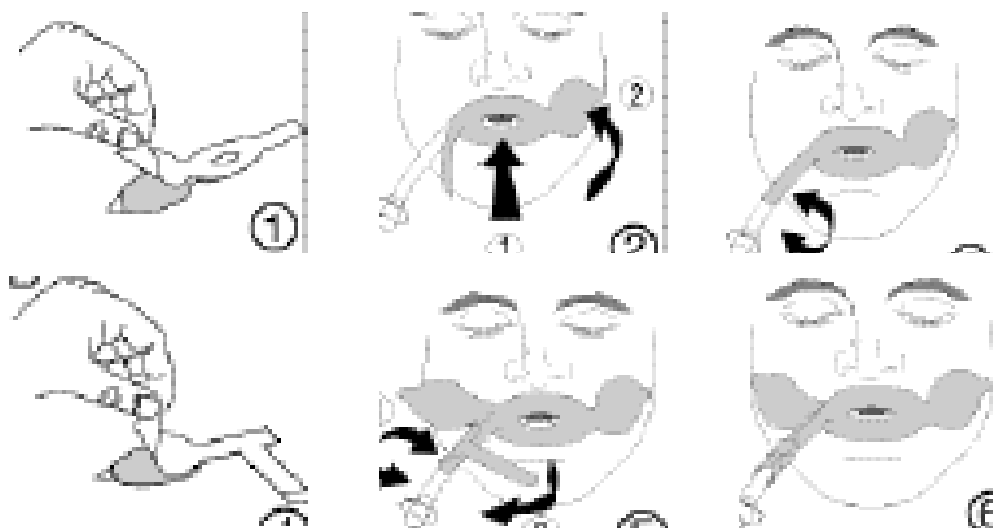

### Upozornění:

Sterilní pouze při neporušeném obalu.

Nepoužívejte po době expiraci.

### Balení:


100 ks

### Označení:

**C** **€** 0123

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>NIKO TUBE-FIX</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Fixace - F</b>	<b>Počet stran:2/2</b>	Viz níže.

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**



**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,**  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**